



AGGIORNAMENTI
CONFUSIONE SESSUALE

2026

AGGIORNAMENTO REPORT 30.07.26

CURVE DI SCARICO E DI RILASCIO DEI DIFFUSORI SHIN-ETSU




Per ogni ulteriore informazione contattare: **BIOGARD - AREA TECNICA**, Divisione di CBC (Europe) S.r.l.
Via Civinelli 1090, 47521 Cesena (FC), Italia Tel. +39 0547 630336
e-mail: tecnicobiogard@cbceurope.it

BIOOtwin[®] L




Aggiornamento: 30.07.26

CURVA DI SCARICO

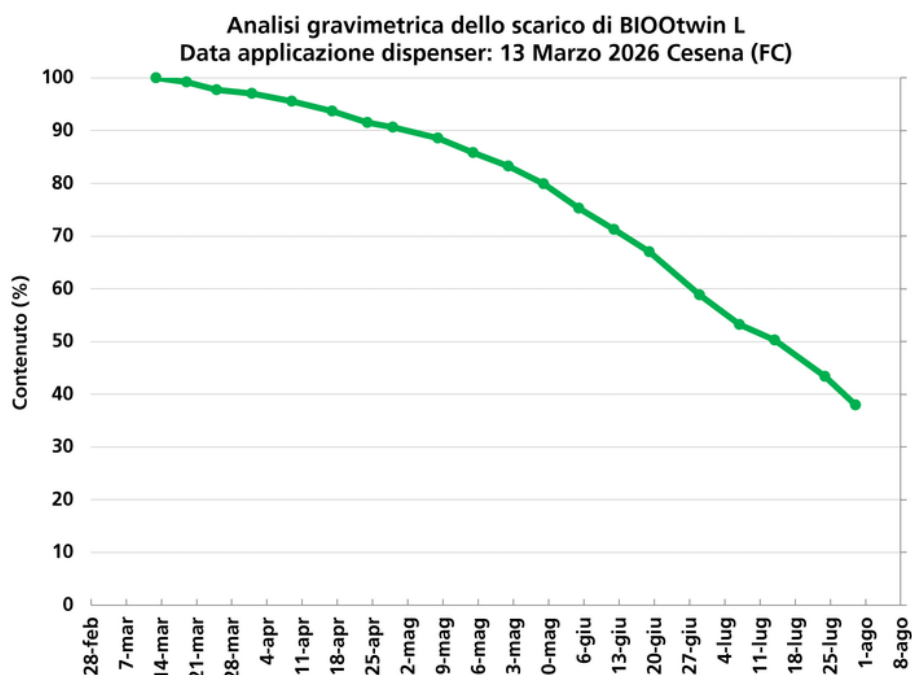

CURVA DI RILASCIO

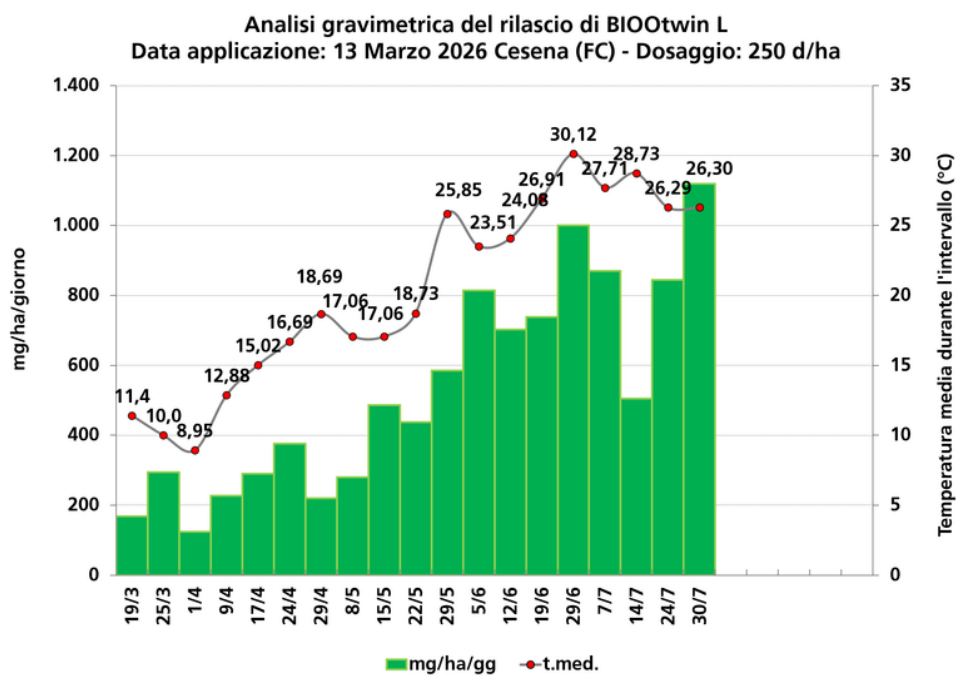


Isonet[®] PF plus




Aggiornamento: 30.07.26

CURVA DI SCARICO

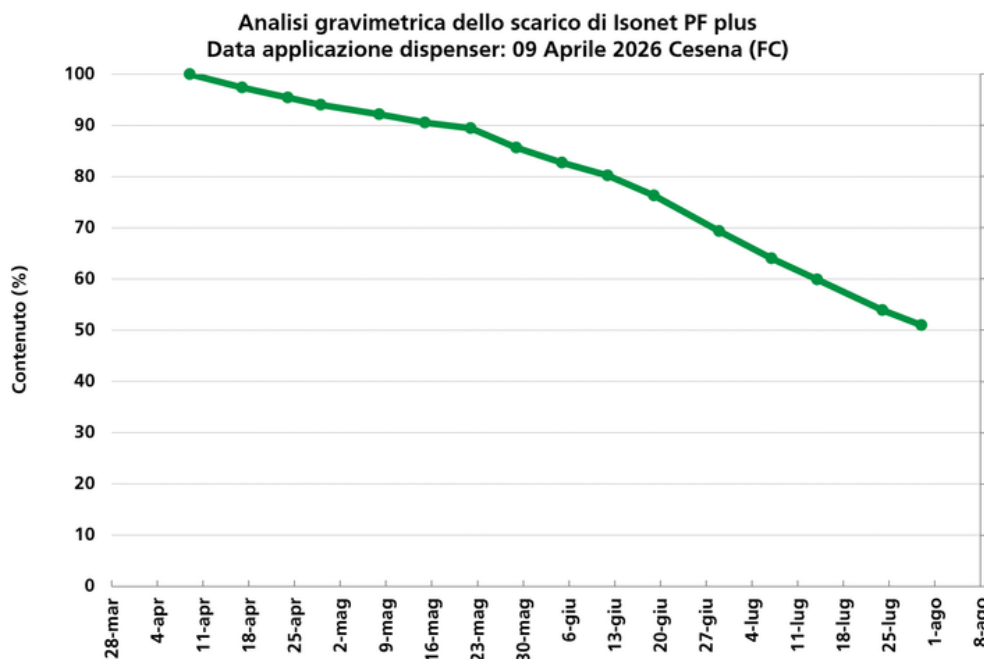

CURVA DI RILASCIO

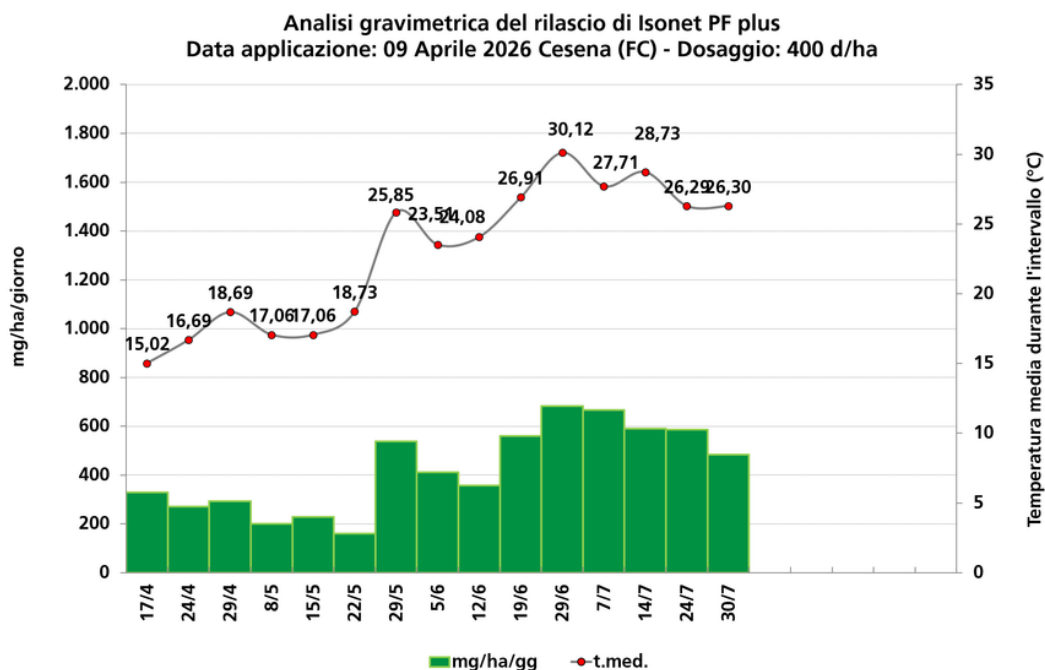


Isonet® L TT




Aggiornamento: 30.07.26

CURVA DI SCARICO

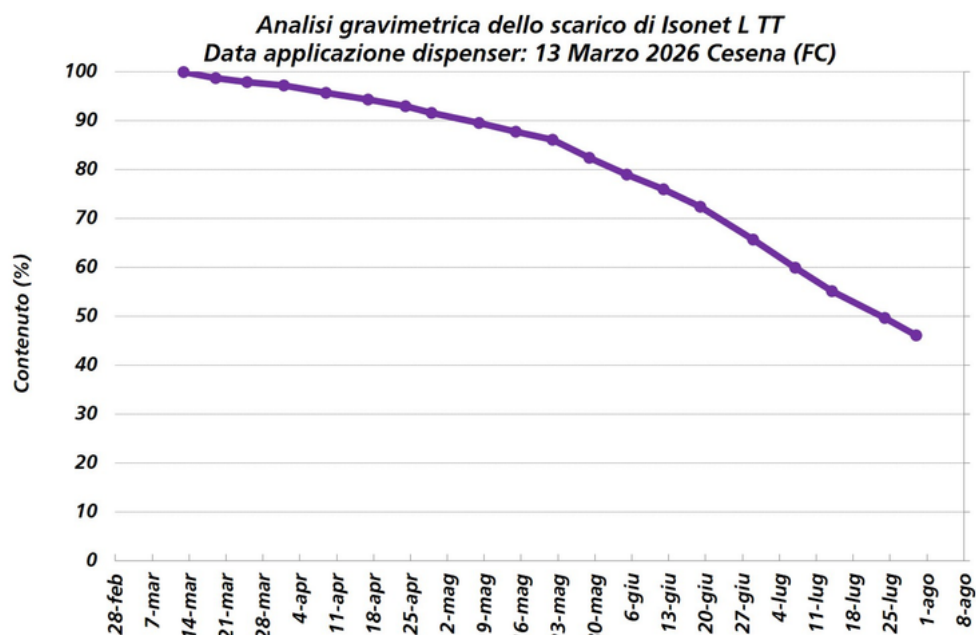

CURVA DI RILASCIO

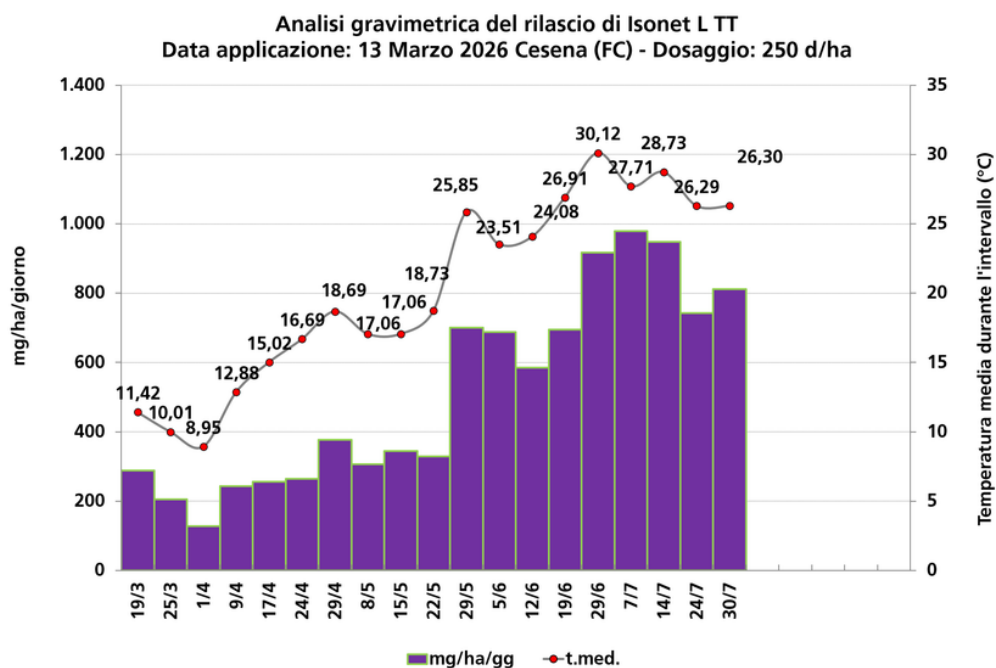


Isomate® C TT




Aggiornamento: 30.07.26

CURVA DI SCARICO

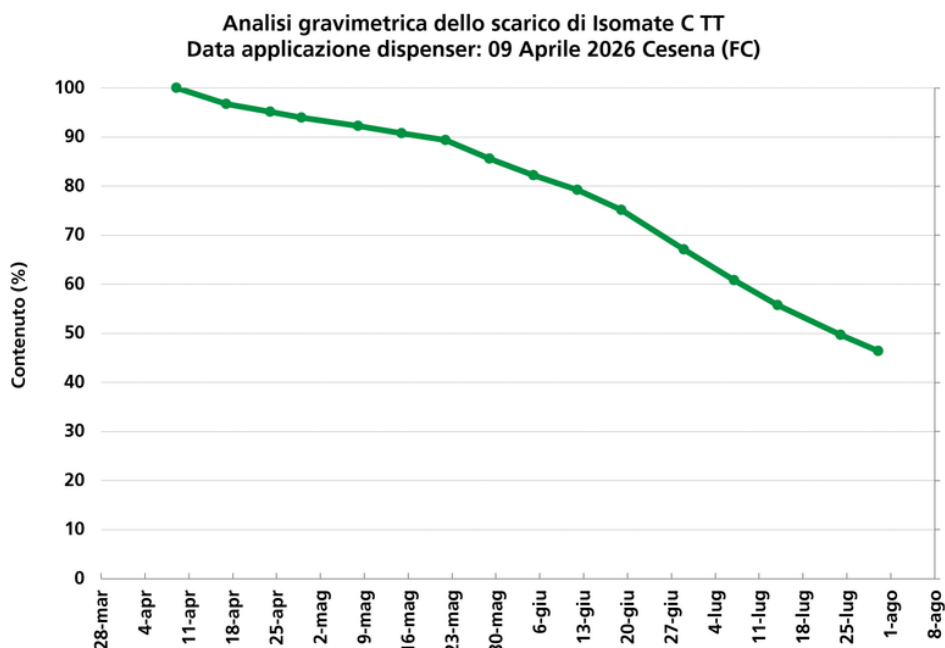

CURVA DI RILASCIO

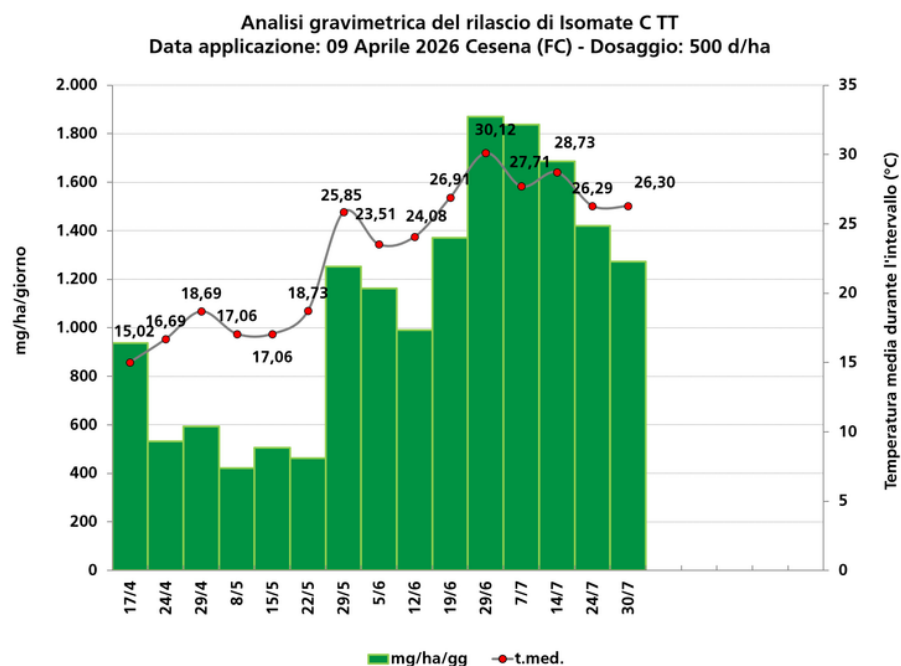


Isomate® A/OFM



Aggiornamento: 30.07.26


CURVA DI SCARICO

Analisi gravimetrica dello scarico di Isomate A/OFM
Data applicazione dispenser: 13 Marzo 2026 Cesena (FC)

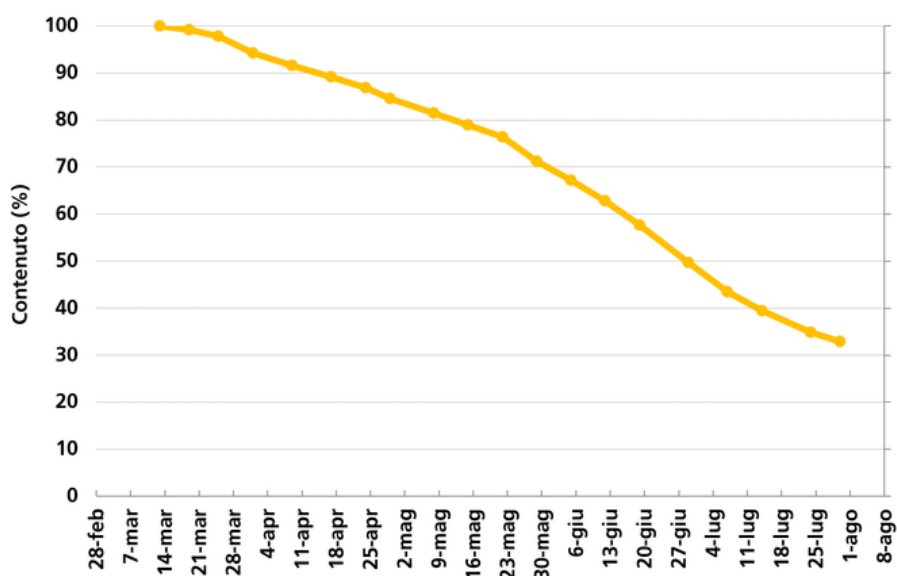

CURVA DI RILASCIO

Analisi gravimetrica del rilascio di Isomate A/OFM
Data applicazione: 13 Marzo 2026 Cesena (FC) - Dosaggio: 1.000 d/ha

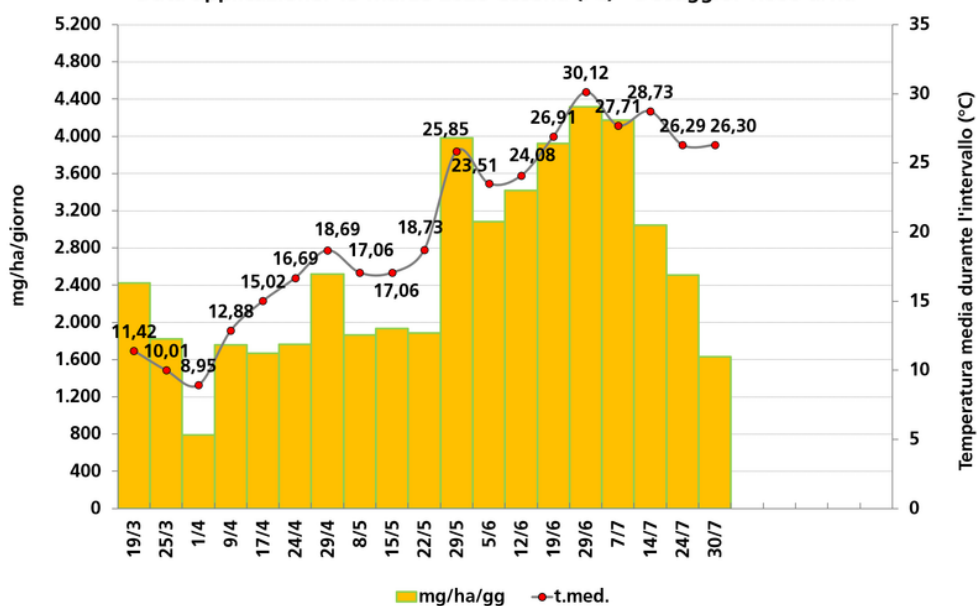


Isomate® OFM rosso FLEX



Aggiornamento: 30.07.26

CURVA DI SCARICO

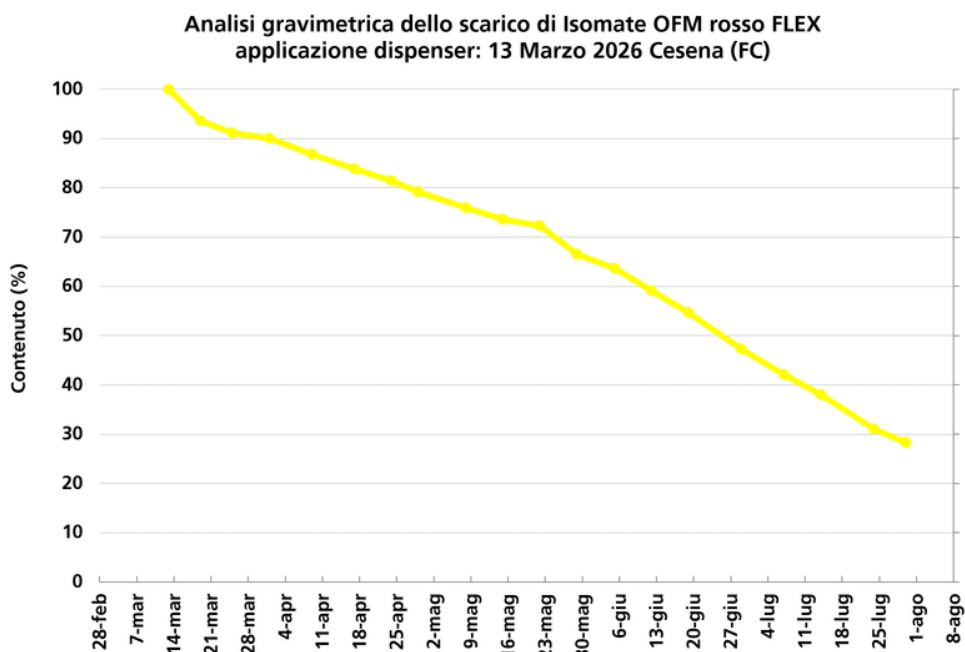

CURVA DI RILASCIO

